


**СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ С ДОЗИМЕТРИ В АНГИОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЯ НА БОЛНИЦА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА  
2016 г.  
Тестовете**

		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 74.71%	СЕСТРА ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 50.88%
Случай 3	БЕЗ ЗАЩИТА	2.61	0.57
Случай 4	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА	0.66	0.28
РЕДУКЦИЯ		74.71%	50.88%




		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 5	БЕЗ ЗАЩИТА - дозиметър върху шапката	15.89
Случай 5	СЪС ЗАЩИТА - дозиметър под шапката	0.01
РЕДУКЦИЯ		99.94%



		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 6	БЕЗ ЗАЩИТА	29.58
Случай 7	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА	1.27
РЕДУКЦИЯ		95.71%




		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 8	БЕЗ ЗАЩИТА - дозиметър върху шапката	12
Случай 9	СЪС ЗАЩИТА - дозиметър под шапката	1.56
РЕДУКЦИЯ		87.00%




		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 11	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	2.34
РЕДУКЦИЯ		93.53%



		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 12	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	7.14
РЕДУКЦИЯ		80.24%




		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 13	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	0.48
РЕДУКЦИЯ		98.67%




		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 14	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	11.00
РЕДУКЦИЯ		69.56%




		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 15	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	2.29
РЕДУКЦИЯ		93.66%




		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 16	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	0.371
РЕДУКЦИЯ		98.97%




		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 17	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	1.28
РЕДУКЦИЯ		96.46%




		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 18	СЪС ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	6.06
РЕДУКЦИЯ		83.23%




		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14




Случай 19	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	1.03
РЕДУКЦИЯ		97.15%




		<b>ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min</b> <b>РЕДУКЦИЯ 99.94%</b>
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 20	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	29.58
РЕДУКЦИЯ		18.15%




		<b>ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min</b> <b>РЕДУКЦИЯ 99.94%</b>
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 21	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	0.16
РЕДУКЦИЯ		99.56%




		<b>ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min</b> <b>РЕДУКЦИЯ 99.94%</b>
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 23	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	0.23
РЕДУКЦИЯ		99.36%




		<b>ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min</b> <b>РЕДУКЦИЯ 99.94%</b>
Случай 10	БЕЗ ЗАЩИТА	36.14
Случай 25	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	0.92
РЕДУКЦИЯ		97.45%



		<b>ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min</b> <b>РЕДУКЦИЯ 99.94%</b>
Случай 26	БЕЗ ЗАЩИТА	6
Случай 28	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА	3.38
РЕДУКЦИЯ		43.67%



		<b>ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА μSV/min</b> <b>РЕДУКЦИЯ 99.94%</b>
Случай 26	БЕЗ ЗАЩИТА	6
Случай 29	СЪС ЗАЩИТНА ПЛАТКА И ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	1.05
РЕДУКЦИЯ		82.50%

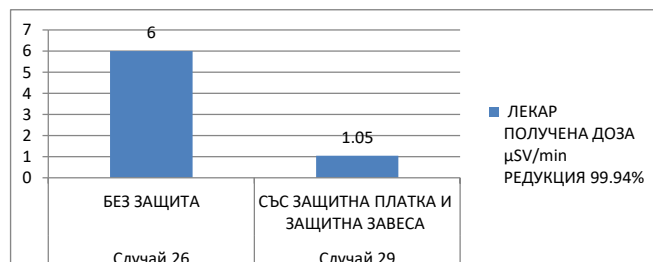

		ЛЕКАР ПОЛУЧЕНА ДОЗА $\mu\text{SV}/\text{min}$ РЕДУКЦИЯ 99.94%
Случай 26	БЕЗ ЗАЩИТА	6
Случай 30	СЪС ЗАЩИТНА ЗАВЕСА	1
РЕДУКЦИЯ		83.33%

